




épreuve paroi épaisse
p. 651

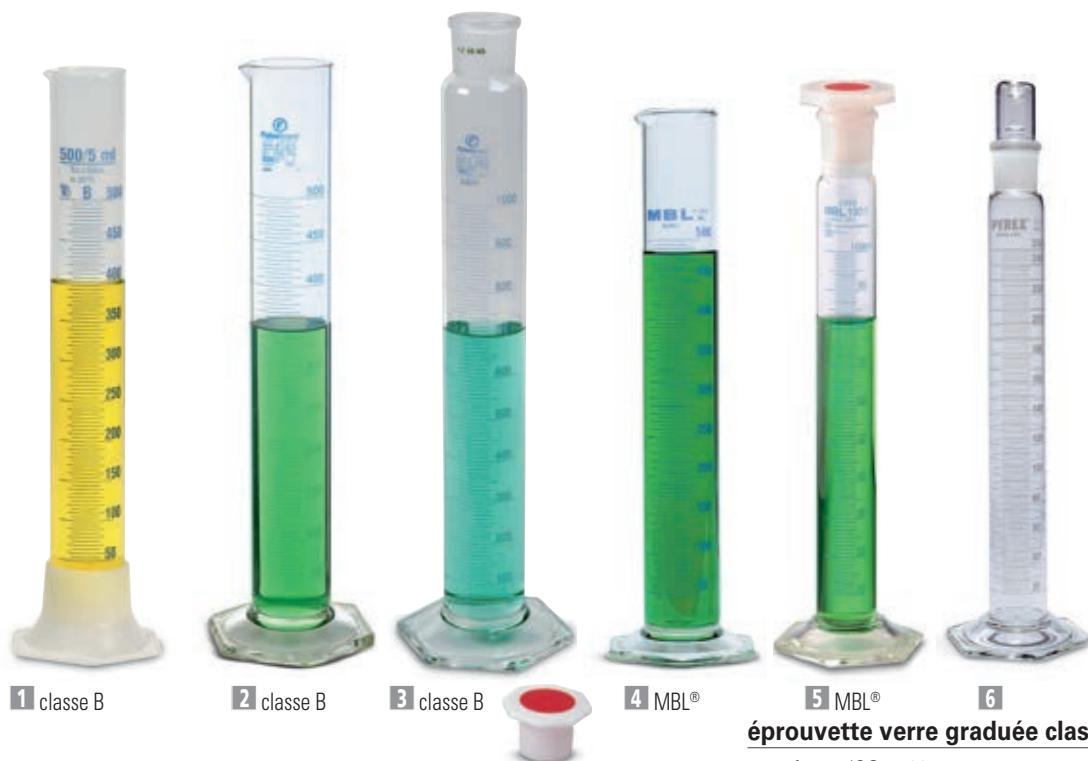

**bague anti-choc
polyéthylène PE**

• pour éprouvette 10 à 1000 ml

Ø externe épreuve	bague anti-choc	/ lot
14 mm	1178-6524	/5
21 mm	1179-6524	/5
25 mm	1178-6534	/5
29 mm	1179-6534	/5
39 mm	1170-6544	/5
54 mm	1171-6544	/5
65 mm	1172-6544	/5

1 classe B

2 classe B

3 classe B

4 MBL®

5 MBL®

6

épreuve verre pied plastique classe B

- conforme DIN EN ISO 4788 • verre sodocalcique
- verre sodocalcique

Fisherbrand®

volume	graduation ml	tolérance ml	Ø x H mm	1 éprouvette classe B	/ lot
10 ml	0,2	±0,2	14 x 140	1187-7942	/10
25 ml	0,5	±0,5	21 x 170	1188-7942	/10
50 ml	1	±1,0	25 x 200	1189-7942	/10
100 ml	1	±1,0	29 x 260	1180-7952	/10
250 ml	2	±2,0	39 x 335	1181-7952	/10
500 ml	5	±5,0	53 x 390	1182-7952	/10
1000 ml	10	±10,0	65 x 470	1183-7952	/10

épreuve classe B en verre borosilicaté

Fisherbrand®

volume	graduation ml	tolérance ml	Ø x H mm	épreuve classe B	/ lot
5 ml	0,1	±0,1	14 x 115	1197-2148	/2
10 ml	0,2	±0,2	16 x 140	1198-2148	/2
25 ml	0,5	±0,5	22 x 170	1202-8738	/2
50 ml	1	±1,0	26 x 200	1199-2148	/2
100 ml	1	±1,0	32 x 245	1034-7822	/2
250 ml	2	±2,0	42 x 325	1023-6042	/2
1000 ml	10	±10,0	69 x 465	1040-2432	/2
2000 ml	20	±20	85 x 565	1199-2138	/1

épreuve graduée classe A

- conforme DIN 12680, ISO 4788
- graduation indélébile émaillée bleue facile à lire
- pied hexagonal stable • verre borosilicaté

volume	grad. ml	tol. ml	H mm	4 éprouvette MBL®	/ lot
5 ml	0,1	±0,1	115	1253-9995	/2
10 ml	0,2	±0,2	140	1194-5406	/2
25 ml	0,5	±0,5	170	1195-5406	/2
50 ml	1	±1,0	200	1196-5406	/2
100 ml	1	±1,0	260	1197-5406	/2
250 ml	2	±2,0	335	1198-5406	/2
500 ml	5	±5,0	390	1192-1473	/2
1000 ml	10	±10,0	470	1199-0895	/2
2000 ml	20	±20,0	570	1132-8064	/1

MBL®

épreuve verre graduée classe B

- conforme ISO 4788
- verre borosilicaté calibré haute résistance chimique
- pied hexagonal stable • verre borosilicaté

volume	graduation ml	tolérance ml	Ø x H mm	2 éprouvette classe B	/ pièce
5 ml	0,1	±0,1	13 x 111	1187-7491	
10 ml	0,2	±0,2	15 x 133	1188-7491	
25 ml	0,5	±0,5	21 x 161	1189-7491	
50 ml	1	±1,0	26 x 195	1180-7501	
100 ml	1	±1,0	31 x 234	1181-7501	
250 ml	2	±2,0	40 x 317	1182-7501	
500 ml	5	±5,0	53 x 380	1183-7501	
1000 ml	10	±10,0	67 x 464	1184-7501	
2000 ml	20	±20	83 x 560	1185-7501	

épreuve verre graduée col rodé classe B

- conforme ISO 4788 • bouchon rodé polypropylène PP bleu
- verre borosilicaté calibré haute résistance chimique
- pied hexagonal stable • verre borosilicaté

Fisherbrand®

volume	graduation ml	tolérance ml	Ø x H mm	rodage cN	3 éprouvette classe B	/ lot
50 ml	1	±1,0	22 x 200	19/25	1206-5645	/2
100 ml	1	±1,0	28 x 290	24/29	1190-3365	/2
250 ml	2	±2,0	37 x 370	29/32	1207-5645	/2
500 ml	5	±5,0	48 x 425	34/35	1170-8265	/2
1000 ml	10	±10,0	61 x 510	45/40	1205-5645	/2
2000 ml	20	±20,0	78 x 610	45/40	1204-5645	/1

épreuve col rodé classe B

- bouchon rodé polyéthylène PE au verre
- graduation indélébile émaillée bleue facile à lire
- conforme DIN 12685, ISO 4788
- pied hexagonal stable • verre borosilicaté

MBL®

volume	grad. ml	tol. ml	H mm	rodage CN	5 éprouvette bouchon PE	/ lot	6 éprouvette Pyrex bouchon verre	/ lot
10 ml	0,2	±0,2	150	10/19	1256-2826	/2	1134-3604	/2
25 ml	0,5	±0,5	180	14/23	1269-2042	/2	1135-3604	/2
50 ml	1	±1,0	210	19/26	1194-1518	/2	1136-3604	/2
100 ml	1	±1,0	270	24/29	1195-1518	/2	1137-3604	/2
250 ml	2	±2,0	350	29/32	1262-2052	/2	1262-2132	/2
500 ml	5	±5,0	390	34/35	1263-2052	/2	1138-3604	/2
1000 ml	10	±10,0	480	45/40	1264-2052	/2	1139-3604	/2
2000 ml	20	±20,0	580	45/40	1210-4432	/1	—	—