

# Humidificateur néonatal

## Hydraltis


Guide de bon usage



## Raccordements :




Raccorder le câble d'alimentation des fils chauffants inspiratoires et expiratoires

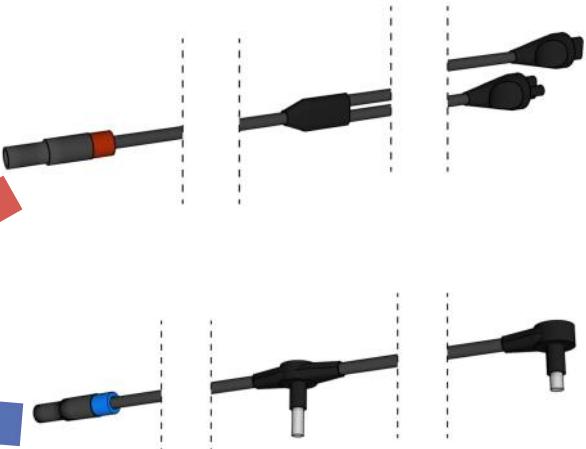

Raccorder le câble des sondes de températures : chambre d'humidification et proximale


## Montage circuits bi-chauffé 07137 NS :

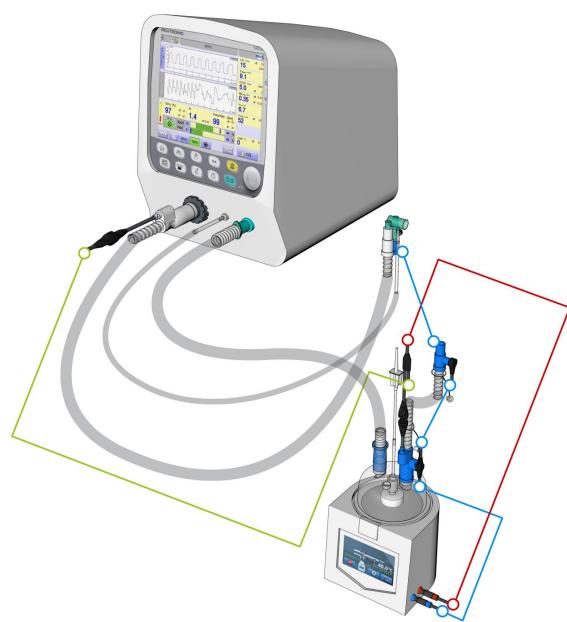

Position sonde température proximale à adapter selon la température de l'incubateur

Paroi incubateur

Extension non chauffée :  
Incubateurs > 35°C  
**À conserver**  
**Sonde de Tp à l'extérieur**



Paroi incubateur


Extension non chauffée :  
Incubateurs < 35°C  
**À retirer**  
**Sonde de Tp à l'intérieur**



## Démarrage de l'humidificateur :

Après démarrage de la ventilation, vérifier le réglage des températures

## Ecran de surveillance :

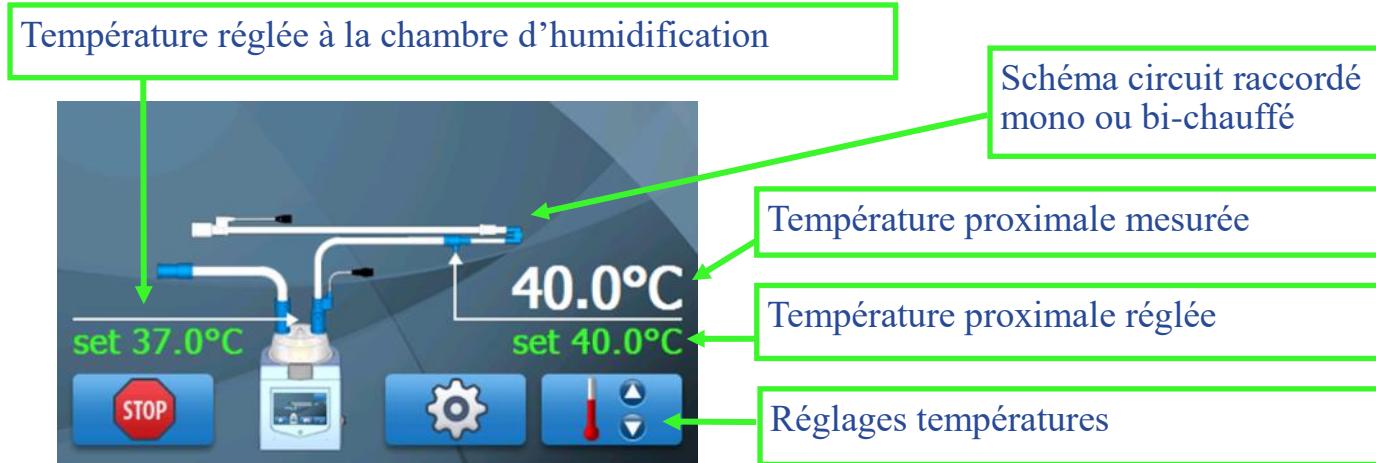

## Ecran de réglage des températures :



## Suggestion de réglages et critères d'ajustement des températures :

Tp incubateur	Sonde et extension	Tp chambre d'humidification	Tp proximale
31-32°C	Intérieur et retirée	35°C	38
33-35°C	Intérieur et retirée	36,5°C	40°C
36-37°C	Extérieur et en place	36,5°C	40°C

### Si condensation en branche inspiratoire :

- Vérifier montage circuit et position sonde selon page N°2
- Ajuster la température de la chambre en baissant de 0,5°C/30 min.

## Alarmes :

- Appuyer sur les icônes d'alarme pour obtenir des informations supplémentaires

Alarme priorité élevée :

Alarme priorité moyenne/basse

Silence alarme :