

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC80021-36	PORTE AIGUILLE MIS L:360MM DROIT DIAMONITE DIA. 3.5MM / 5MM VERROUILLAGE FACILE	3661219442851
	MIS NEEDLE HOLDER L:360MM STRAIGHT DIAMONITE DIA. 3.5MM / 5MM EASY TO LOCK	 3 661219 442851

Catalogues / catalogs

MIS 2021

Chapitre-page

91


DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Diamonite Needle Holders / Porte-Aiguilles Diamonite / Porta Agujas de Diamonite


Diamonite


Easy Lock System

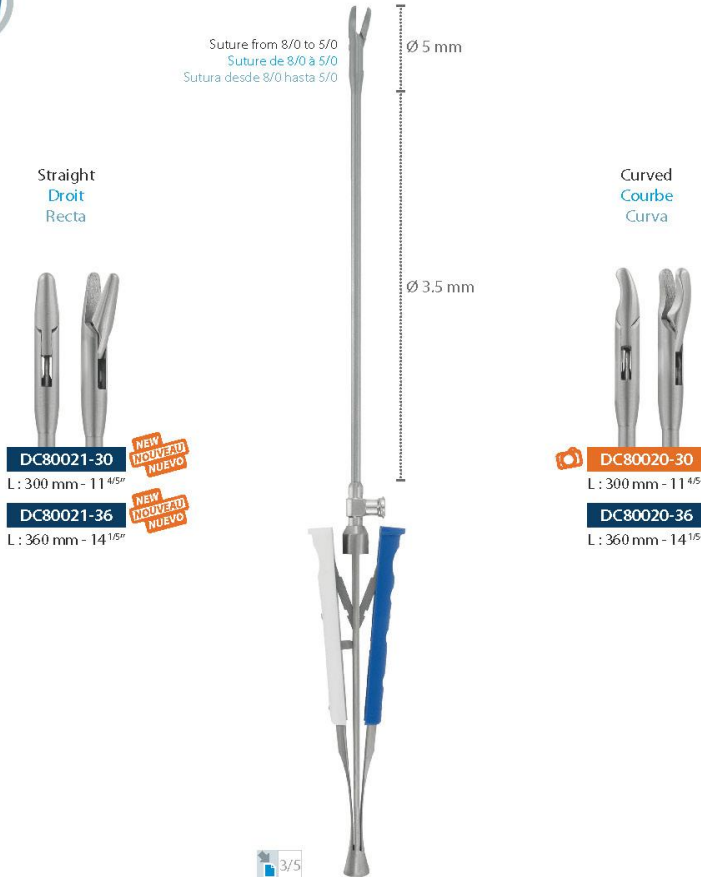



Straight
Droit
Recta



DC80021-30
L : 300 mm - 11^{4/5}"

DC80021-36
L : 360 mm - 14^{1/5}"

Suture from 8/0 to 5/0
Suture de 8/0 à 5/0
Sutura desde 8/0 hasta 5/0

Ø 5 mm

Ø 3.5 mm

Curved
Courbe
Curva



DC80020-30
L : 300 mm - 11^{4/5}"

DC80020-36
L : 360 mm - 14^{1/5}"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3/5

NEW
NOUVEAU
NUEVO

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC80021-36	PORTE AIGUILLE MIS L:360MM DROIT DIAMONITE DIA. 3.5MM / 5MM VERROUILLAGE FACILE	3661219442851
	MIS NEEDLE HOLDER L:360MM STRAIGHT DIAMONITE DIA. 3.5MM / 5MM EASY TO LOCK	 3 661219 442851

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + POLYMERE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + POLYMER + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306) + POLYPROPYLENE + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

MIS 2021

91

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*