

## GUIDE D'UTILISATION DES ÉLECTRODES

En prenant soin de vos électrodes, vous augmenterez leur durée de vie et le confort de stimulation.



1 Assurez-vous que la peau est propre, sèche, sans aucune crème ou lotion.

2 Retirer l'électrode de son support en la saisissant par le bord ou l'onglet prévu à cet effet.



3 Insérer la fiche banane du câble de stimulation dans la connectique de l'électrode en saisissant fermement les coques plastiques.

4 Repositionner toujours l'électrode sur la face ON du support plastifié.



5 Ne jamais plonger l'électrode dans l'eau.

6 Ne jamais décoller l'électrode de son support en saisissant le câble de connectique.



7 Ne jamais déconnecter l'électrode en tirant sur les câbles de connexion.

8 Ne pas repositionner l'électrode sur la face NO du support plastifié.

- L'usage individualisé des électrodes est recommandé.
- Se reporter au manuel d'utilisation du stimulateur pour connaître le format d'électrode adapté à chaque zone anatomique.
- Une légère noisette de gel peut être ajoutée sous l'électrode.
- Toujours repositionner les électrodes dans leur emballage d'origine et les stocker à température ambiante.
- Des électrodes pour peaux sensibles sont recommandées en cas d'allergies.



Pensez aux électrodes individuelles,  
c'est garantir une hygiène maximale,  
mais pas que...



**POUR UNE HYGIÈNE MAXIMALE**  
*1 sachet = 1 patient*

**POUR UN CONFORT ET UNE SÉCURITÉ OPTIMALE**  
*ranger les électrodes correctement sur leur support et les stocker au frais.*  
*renouveler vos électrodes régulièrement*




DJO France S.A.S. | Centre Européen de Frêt | 3 rue de Bethar |  
64990 Mouguerre | Tél. : 05 59 52 86 90 | Fax : 05 59 52 86 91



© DJO France MKGRSMED356 - Rev A - 10/2020 - Dispositif médical de classe I.  
Fabricant : DJO LLC. - Lire attentivement les notices et demander conseil à un professionnel de santé.



**TRAITEMENT EN ÉLECTROTHERAPIE**  
**PENSEZ AUX ÉLECTRODES INDIVIDUELLES PAR MESURE D'HYGIÈNE**

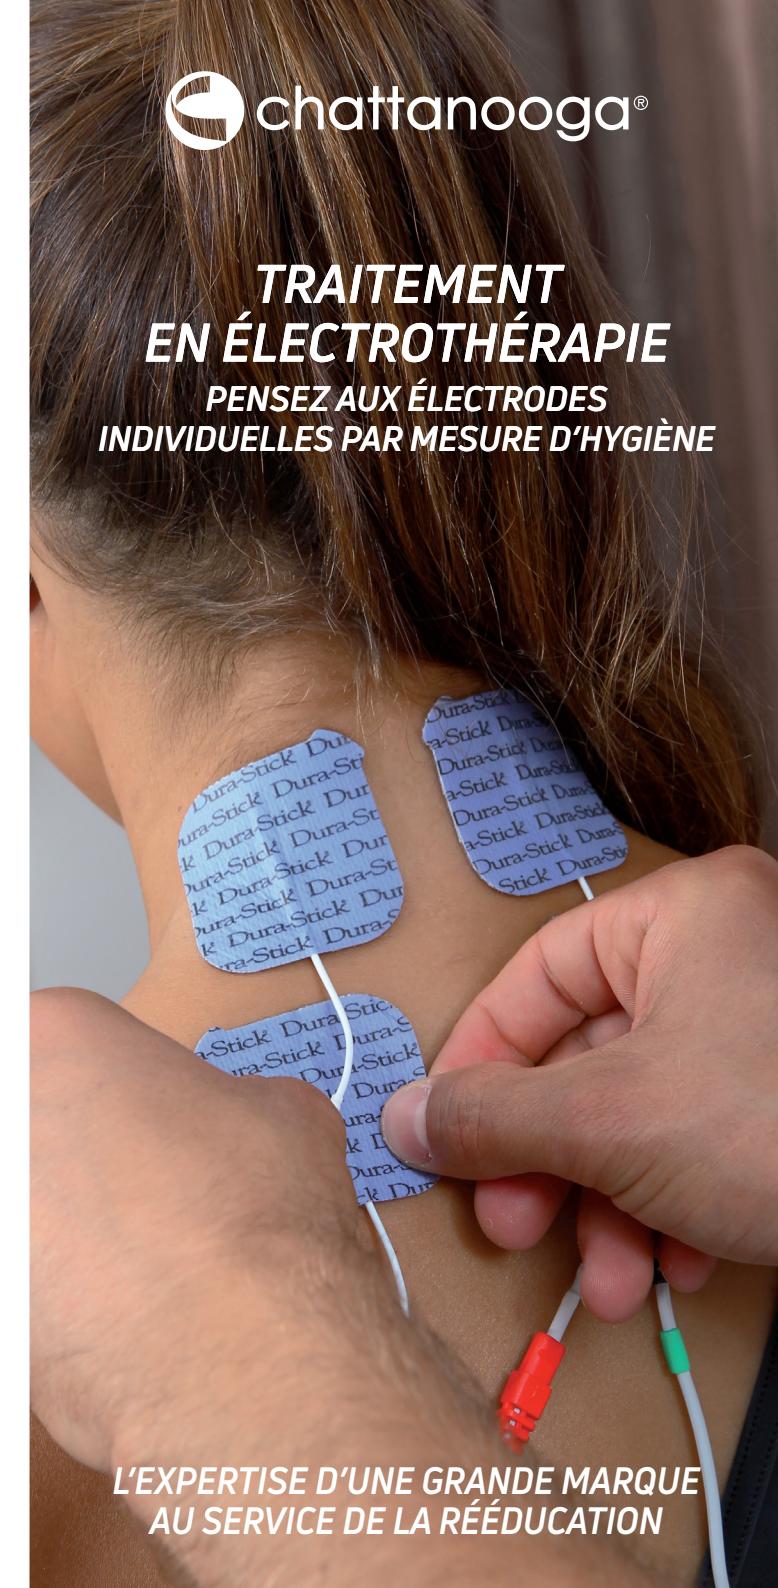

**L'EXPERTISE D'UNE GRANDE MARQUE AU SERVICE DE LA RÉÉDUCATION**

## QUALITÉ, CONFORT, EFFICACITÉ

La qualité d'un traitement par électrostimulation est directement liée à la qualité des électrodes utilisées.

Les électrodes Dura-Stick® sont reconnues pour leur qualité par leur gel MultiStick™ des électrodes Dura-Stick® et Gel hypoallergénique des électrodes Dura-Stick® Premium Blue gel.



**CONNECTIQUE** Connectique universelle adaptée à différents types d'appareils : fiches banane mâles 2 mm ou snap.

**FORMAT** Nombreux formats adaptés à toutes les zones anatomiques : rondes diamètre 32 mm ou 50 mm, carrées, rectangulaires.

**MÉTHODE DE CONDUCTION** 1 000 brins d'acier pour une meilleure répartition du courant, un meilleur confort et une plus grande longévité.

**SOUPLESSE** Revêtement en textile souple (électrodes Dura-Stick® Plus) ou en polyuréthane (électrodes Dura-Stick® Premium).

**LONGÉVITÉ** 20 à 60 séances selon la gamme concernée.

## ÉLECTRODES DURA-STICK®



À PARTIR DE  
**4,00€** TTC

### AVANTAGES

**Longévité** : plus de 20 séances.

**Économique** : un positionnement prix incomparable.

FORMAT	RÉFÉRENCE
Fil 50 x 50 mm - (x 4)	42190

## ÉLECTRODES DURA-STICK® PLUS



À PARTIR DE  
**5,48€** TTC

### AVANTAGES

**Longévité** : plus de 40 séances.

La référence des électrodes sur le marché.

FORMAT	RÉFÉRENCE
Fil ø 32 mm - (x 4)	42219
Fil ø 50 mm - (x 4)	42197
Fil 50 x 90 mm - (x 4)	42199
Fil 50 x 50 mm - (x 4)	42198
Fil 50 x 100 mm (2 sorties) - (x 2)	42200

## ÉLECTRODES DURA-STICK® PREMIUM



À PARTIR DE  
**9,86€** TTC

### AVANTAGES

**Longévité** : plus de 60 séances.

**Confort** : pour les patients à peaux sensibles présentant des irritations suite à l'utilisation d'électrodes traditionnelles.

FORMAT	RÉFÉRENCE
Fil ø 32 mm - (x 4)	42205
Fil ø 50 mm - (x 4)	42206
Fil 40 x 60 mm - (x 4)	42207
Fil 80 x 130 mm - (x 2)	42208

## CARACTÉRISTIQUES

**Dessus** : film textile blanc non lavable.

**Dessous** : film carbone. Gel Multistick™ hypoallergénique.

**Connexion** : électrodes à fil.

FORMAT	RÉFÉRENCE
Fil 50 x 90 mm - (x 4)	42191

chattanooga®

## CARACTÉRISTIQUES

**Dessus** : film textile non lavable.

**Dessous** : microtissage de fil métal. Gel hypoallergénique.

**Connexion** : électrodes à fil pour toutes les dimensions ou snap.

FORMAT	RÉFÉRENCE
Snap 50 x 50 mm - (x 4)	42204
Snap 50 x 100 mm 1 Snap - (x 2)	42223
Snap 50 x 100 mm 2 Snaps - (x 2)	42203
Stimgel 50 x 50 mm - (x 4) pour TENS Belt	199598V

chattanooga®

## CARACTÉRISTIQUES

**Dessus** : film isolant polyuréthane, gris lavable.

**Dessous** : microtissage de fil métal. Gel hypoallergénique.

**Connexion** : électrodes à fil.

FORMAT	RÉFÉRENCE
Fil 50 x 50 mm - (x 4)	42209
Fil 50 x 89 mm - (x 4)	42210
Fil 50 x 50 mm (pour peaux sensibles) - (x 4)	42211
Fil 40 x 90 mm (pour peaux sensibles) - (x 4)	42212

Commande minimum : 10 sachets sauf références peaux sensibles (42212 et 42211) 5 sachets.