




Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00  
Fax: 01 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)

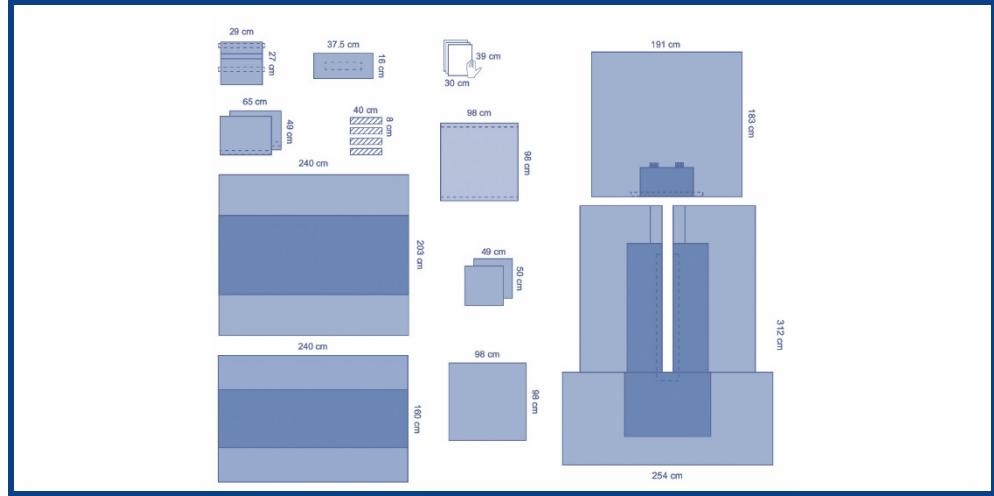

## Eclipse®

## Trousse de CEC

### Référence(s)

CP29225CE

### Description

Un carré de transfert 120x120 cm contient :

- 1 couvre-table 160x240 cm, 90 µm contenant :
  - 1 champ de pied spunlace 183x191 cm, avec renfort absorbant 37x67 cm, 2 passe-tubulures, adhésif
  - 1 champ spunlace 98x98 cm
  - 1 champ fendu cardiovasculaire en spunlace 254x312 cm, U adhésif 13x202 cm, avec renfort absorbant 74x104 cm
  - 2 champs renforcés de Polyrayon 49x50 cm
  - 2 champs trilaminés 65x49 cm, adhésifs
  - 4 bandes adhésives transparentes 8x40 cm
  - 1 couvre-table 203x240 cm, 90 µm, plié
  - 1 champ spunlace 98x98 cm, adhésif
  - 3 essuie-mains 39x30 cm, dépliés
  - 1 cache périnée trilaminée 16x37,5 cm, adhésive
  - 1 poche à instruments spunlace 29x27 cm, adhésive

### Matière(s)

Trilaminée absorbante et imperméable (polyéthylène + polypropylène)  
Eclipse® spunlace (polyester + fibres de cellulose)  
Renfort absorbant Polyrayon (polyester + viscose)

### Conditionnement

3 unités par carton

### Emballage

Sachet de stérilisation à entête  
1 sac en polyéthylène contient l'ensemble des unités dans un carton

### Fabricant

Medline International France SAS  
EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE  
Classe du dispositif : I stérile  
HP : Conforme aux exigences de Haute Performance de la norme EN 13795



Sans latex



2797



STERILE|EO



© 2020 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.  
Tous droits réservés.

TDS\_CardiovascPack\_CP29225CE\_FR02

01.INT.03.30