




Medline France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel : 01 30 05 34 00

Fax : 01 30 05 34 52

[www.medline.com/fr](http://www.medline.com/fr)

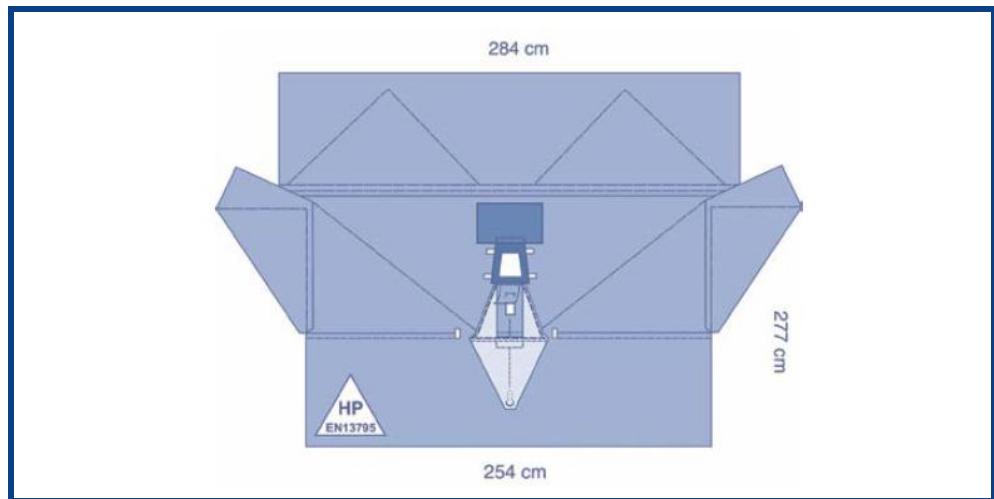

## OPS™ Ultimate

# Champ d'hystérectomie assistée par laparoscopie

### Référence(s)

TB29474CE

### Description

Un carré de transfert 112x112 cm contient :

- 1 champ d'hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie, trilaminé, 254/284x277 cm, avec fenêtre abdominale trapézoïdale adhésive 18x23x23 cm, fenêtre périnéale adhésive 8x15 cm, poche de recueil avec embout d'évacuation, plis d'aisance, jambières intégrées, tapis à instruments 25x45 cm, et 6 passe-tubulures

### Matière(s)

Trilaminé absorbant et imperméable (polypropylène + polyéthylène)

Renfort absorbant HSPP (polypropylène + polyéthylène)

### Conditionnement

5 unités par carton

### Emballage

Sachet de stérilisation

1 sac polyéthylène contient l'ensemble des sachets individuels

### Fabricant

Medline International France SAS

Certifié EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE

Classe du dispositif : I stérile

HP : Conforme aux exigences de haute performance de la norme EN 13795



Sans latex



0086



STERILE|EO



© 2014 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.  
Tous droits réservés.

LIT-TB29474CE-FR03

01.01.INT.12