


# RD SET™

## SofTouch™ Replacement Wraps

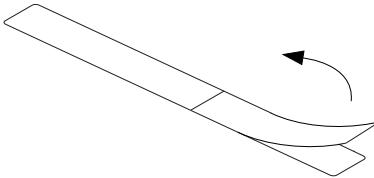

Images	2
<b>en</b> English	3
<b>fr</b> French	4
<b>de</b> German	5
<b>it</b> Italian	6
<b>es</b> Spanish (International)	7
<b>sv</b> Swedish	8
<b>nl</b> Dutch	9
<b>da</b> Danish	10
<b>pt</b> Portuguese (Portugal)	11
<b>zh</b> Chinese (Simplified)	12
<b>ja</b> Japanese	13
<b>fi</b> Finnish	14
<b>no</b> Norwegian	15
<b>cs</b> Czech	16
<b>hu</b> Hungarian	17
<b>pl</b> Polish	18
<b>ro</b> Romanian	19
<b>sk</b> Slovak	20
<b>tr</b> Turkish	21
<b>el</b> Greek	22
<b>ru</b> Russian	23
<b>ar</b> Arabic	24
<b>fa</b> Farsi	25

# RD SET™

## SofTouch™ Replacement Wraps

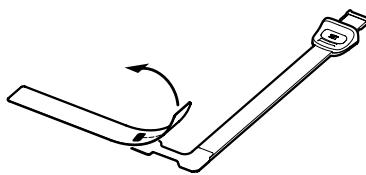


Fig. 1

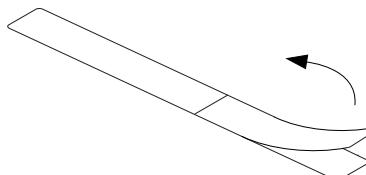


Fig. 2

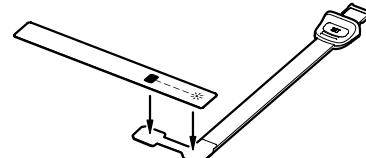


Fig. 3

## Mode D'EMPLOI

 utilisation sur un seul patient

 Ne contient pas de latex naturel

 Non stérile
**DESCRIPTION**

Les bandes de recharge RD SET™ SofTouch™ sont conçues pour remplacer les bandes de fixation des capteurs à usage unique RD SET si ces dernières étaient salies ou déchirées pendant la durée de vie du capteur.

**INSTRUCTIONS**

1. Retirer et jeter la bande de fixation existante (Fig. 1).
2. Retirer la feuille protectrice de la bande de fixation (Fig. 2).
3. Positionner la bande de recharge sur le capteur, en alignant le composant de l'émetteur sur le câble du capteur. (Fig. 3).

**Les symboles suivants peuvent figurer sur le produit ou son étiquette :**

SYMBOLE	DÉFINITION	SYMBOLE	DÉFINITION
	Consulter le mode d'emploi		Marque de conformité à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE
	Suivre les instructions d'utilisation		Représentant agréé dans l'Union européenne
	Fabricant		Code de lot
	Date de péremption AAAA-MM-JJ		Référence du catalogue (référence du modèle)
	Ne pas réutiliser/Produit à usage unique/utilisation sur un seul patient		Patient pédiatrique
	Non stérile		Limite d'humidité de stockage
	Ne contient pas de latex naturel		Plage de température de stockage
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		Conserver au sec
<b>Rx ONLY</b>	<b>Mise en garde :</b> la loi fédérale (États-Unis) restreint la vente de cet appareil par ou sur prescription d'un médecin.		Les instructions/modes d'emploi/manuels sont disponibles en format électronique à l'adresse <a href="http://www.Masimo.com/TechDocs">http://www.Masimo.com/TechDocs</a> <b>Remarque : elFU n'est pas disponible pour les pays où le marquage CE est ou doit être utilisé.</b>
####	Numéro de référence Masimo		Pression atmosphérique (limite)

RD SET est une marque de commerce de Masimo Corporation.



© 2017 Masimo Corporation

 Manufacturer:  
Masimo Corporation  
52 Discovery  
Irvine, CA 92618  
USA

[www.masimo.com](http://www.masimo.com)

Authorized representative  
in the European community:



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



9018D-eIFU-0417