





GUIDE Brassards de tension artérielle Welch Allyn FlexiPort™

1 Positionnement du brassard

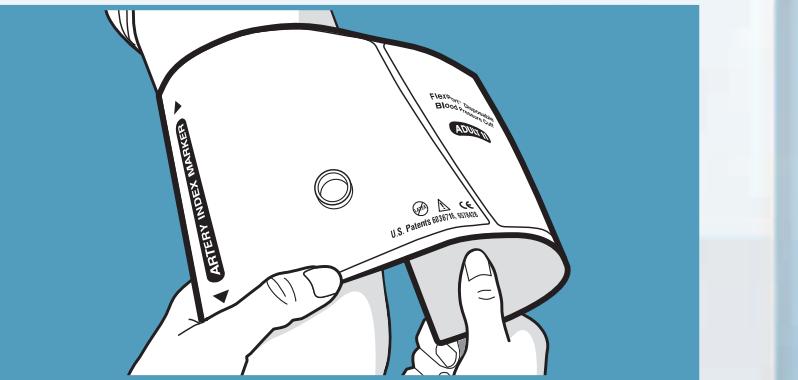


Positionnez le marqueur d'index artériel sur l'artère brachiale du patient et enroulez le brassard autour du bras du patient.

2 Vérification

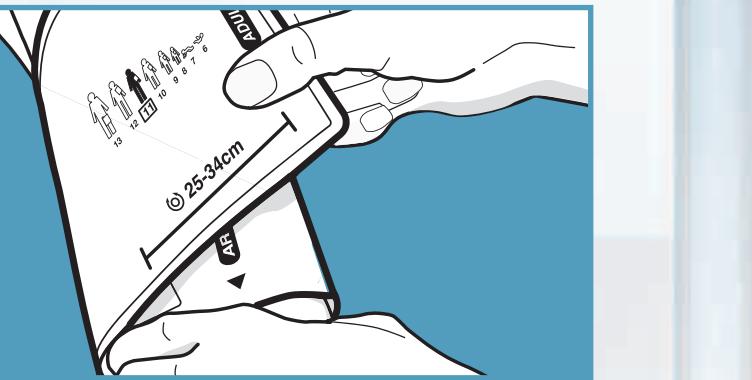


Assurez-vous que le marqueur de l'indice artériel se situe dans la plage indiquée sur le brassard.

3 Fixation

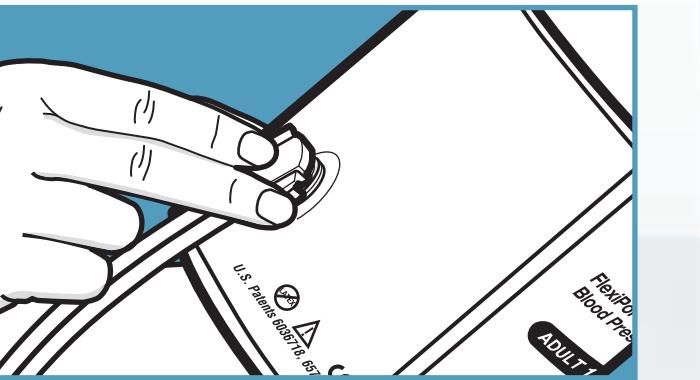


Clipsez le raccord FlexiPort, du dispositif directement dans le brassard.

4 Rotation

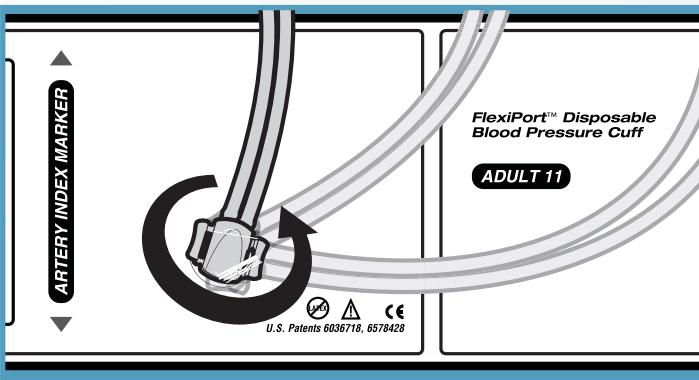

Faites pivoter la tubulure du dispositif pour obtenir une position confortable pour le patient et le soignant.

5 Détachement

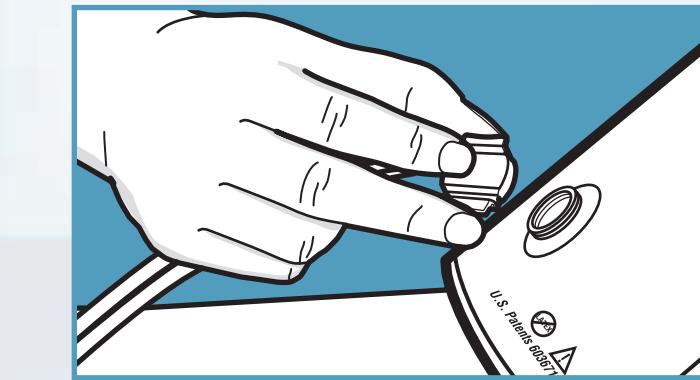

Appuyez sur le raccord FlexiPort et tirez-le pour le détacher du brassard.