

PIÈCE DÉTACHÉE

CLEAR FUSE® A10807


MANOMÈTRE POUR MANCHETTES À PRESSION

FICHE TECHNIQUE



CE 0459

1/2

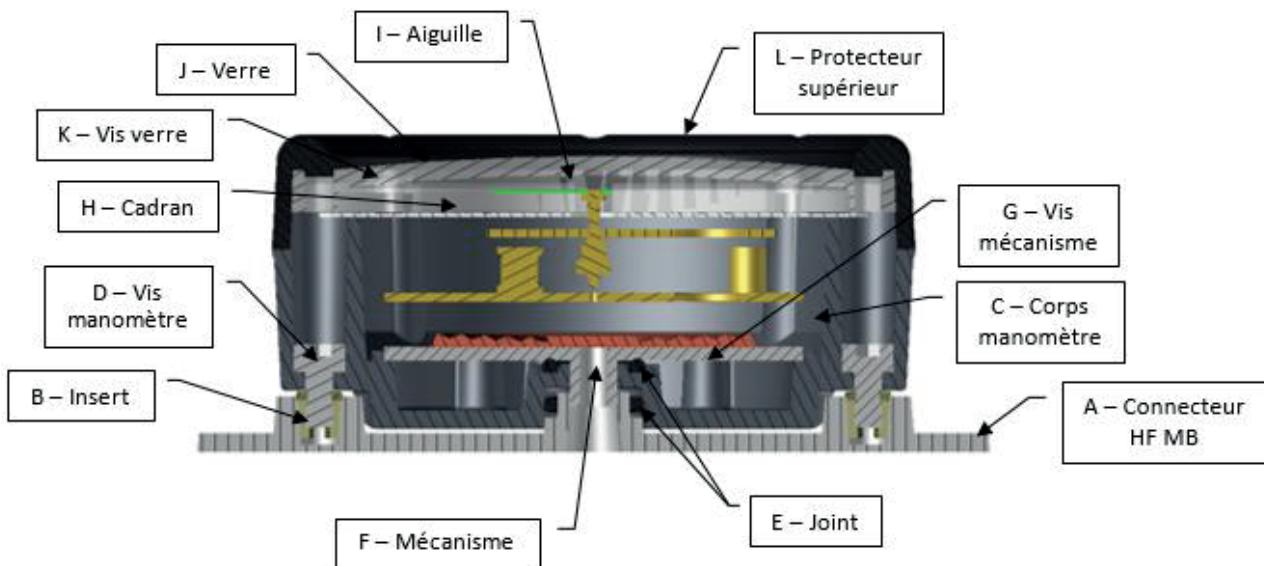

Matériaux utilisés :

- Manomètre : ABS
- Verre protecteur : polycarbonate
- Protecteur : TPU

Désignation	Dimensions en mm		Référence
	Diamètre	Hauteur	
Manomètre pour manchette à pression ClearFuse®	69	51,6	A10807

Il est recommandé d'effectuer un étalonnage **tous les 12 mois**.
Celui-ci doit être fait par une personne **formée et habilitée**.

LA QUALITÉ DDM

Marquage CE 0459

Les manchettes à pression sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

Centre de support technique client

GSH assure la maintenance et la réparation des manchettes à pression.
Contactez notre SAV au : +33 4 42 90 31 31.

Garantie

Les manchettes à pression DDM sont garanties 24 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.