

**Fibre Laser et Endo-illumination****Fibre Laser et Endo-illumination, vektor articulée 25G**

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concerne une référence, un type ou une famille de DM

**1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise**

Date d'édition : 16 février 2018

1.1 **Nom** : Laboratoires ALCON

1.2 **Adresse complète** :

20, rue des Deux Gares  
92842 RUEIL MALMAISON cedex

Tel: 01.47.10.47.10 Fax : 01.47.10.47.00

E-mail :

Pour toute commande : [chirurgie.commande@alcon.com](mailto:chirurgie.commande@alcon.com)

Pour toute autre demande : [serviceclient.chirurgie@alcon.com](mailto:serviceclient.chirurgie@alcon.com)

Site internet : [www.alcon.fr](http://www.alcon.fr)

1.3 **Coordonnées du correspondant  
matériovigilance** :

Tel : 01.47.10.47.58

Fax : 01.47.10.27.70

e-mail : [Vigilances.France@alcon.com](mailto:Vigilances.France@alcon.com)

**2. Informations sur dispositif ou équipement**

2.1 **Dénomination commune** : Fibre Laser et Endo-illumination

2.2 **Dénomination commerciale** : Fibre Laser et Endo-illumination, vektor articulée 25G

2.3 **Code nomenclature** : 17193

**Code Cladimed** : S50EC08

2.4 **Code LPPR\* (ex TIPS si applicable)** :

\* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1

2.5 **Classe du DM** : IIb

**Directive de l'UE applicable** : 93/42/CEE

**Selon Annexe n°II**

**Numéro de l'organisme notifié** : 0123 (TÜV)

**Date de première mise sur le marché dans l'UE** :

**Fabricant du DM** : Laboratoires Alcon

2.6 **Descriptif du dispositif** : Utilisée en segment postérieur pour la chirurgie laser intraoculaire

Trousse : Non

Si Oui, composition de la trousse :

2.7 Références Catalogue : 8065752555

Code SAP : 100109319

**RÉFÉRENCE** : 8065752555 : FIBRE ENDOLAS VEKT ART 25G 6/B**Conditionnement / emballages****UCD** (Unité de Commande) : 1 Boîte**CDT** (Conditionnement) : 6 Unités**QML** (Quantité minimale de livraison) : 1 Boîte**Descriptif de la référence :**

Lasers endophotocoagulateurs Purepoint®.

Constellation® Vision System.

Equipé du système RFID sur le laser Purepoint®

Equipé du double système RFID, reconnaissance RFID sur le laser + reconnaissance RFID sur l'appareil de vitrectomie.

Endoillumination + Laser

Fibre articulée

**Caractéristiques de la référence :** Diamètre : 25G**Etiquetage :**

2.8 Composition du dispositif et Accessoires :

**ÉLÉMENTS et MATERIAUX :**

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

2.9 **Domaine - Indications :**Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) Chirurgie vitréo-rétinienne / segment postérieur  
Indications (selon liste Europharmat) : Utilisée en segment postérieur pour la chirurgie laser intraoculaire**3. Procédé de stérilisation****DM stérile :** Oui**Mode de stérilisation du dispositif :** Oxyde d'Ethylène ou Rayonnements

#### 4. Conditions de conservation et de stockage

Conditions normales de conservation et de stockage

#### 5. Sécurité d'utilisation

5.1 Sécurité technique :

5.2 Sécurité biologique (s'il y a lieu) :

#### 6. Conseils d'utilisation

6.1 Mode d'emploi : Cf. Notice

6.2 Indications : Utilisée en segment postérieur pour la chirurgie laser intraoculaire

6.3 Précautions d'emploi : Cf. Notice

6.4 Contre-Indications : Cf. Notice



Fibre Laser et Endoillumination Vektor Articulée 25G

# ALCON® LASER PROBES

## Laser, Illuminated Laser and Aspirating Laser Probes

### DIRECTIONS FOR USE:

ENGLISH .....	1-2
BULGARIAN / Български .....	3-4
CZECH REPUBLIC / ČESKY .....	5-6
DANISH / DANSK .....	7-8
DUTCH / NEDERLANDS .....	9-10
ESTONIAN / EESTI .....	11-12
FRENCH / FRANÇAIS .....	13-14
GERMAN / DEUTSCH .....	15-16
GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ .....	17-18
HUNGARIAN / MAGYAR .....	19-20
ITALIAN / ITALIANO .....	21-22
LITHUANIAN / LIETUVIŠKA .....	23-24
NORWEGIAN / NORSK .....	25-26
POLISH / POLSKI .....	27-28
PORTUGUESE / PORTUGUÊS .....	29-30
ROMANIAN / ROMÂNĂ .....	31-32
RUSSIAN / РУССКИЙ .....	33-34
SLOVAKIAN / SLOVENSKY .....	35-36
SPANISH / ESPAÑOL .....	37-38
SWEDISH / SVENSKA .....	39-40
UKRAINIAN / Український .....	41-42

Languages not translated are listed on the back page



**Alcon®**

a Novartis company

## Sondes laser, sondes laser éclairantes et sondes laser aspirantes - Mode d'emploi

**ATTENTION :** Ce mode d'emploi ne dispense pas de lire et de comprendre votre manuel d'utilisation. Ce manuel, fourni avec le laser et la source de lumière, comporte des informations détaillées permettant à l'équipe chirurgicale de se familiariser avec les commandes et les fonctions du laser et de la source de lumière.

**DESCRIPTION :** Chaque emballage contient une sonde laser stérile.

### Mode d'emploi de la sonde laser articulée éclairante **Vektor\*** uniquement :

Pour une utilisation de la source de lumière avec le système laser **Purepoint** System (œil, rattaché ou incorporé au **Constellation** Vision System)

Pour une utilisation de la source de lumière avec le **Constellation** Vision System, la console **Accurus**\* ou le système illuminateur Haute Luminosité (HHL) **Accurus**\*. Les sondes avec Dispositif d'identification par Fréquence Radio (RFID) **ENGauge**\* peuvent être utilisées avec la console **Accurus**\* ou le système illuminateur Haute Luminosité (HHL) **Accurus**\* en utilisant l'adaptateur RFID modèle numéro 8065751140.

1 De manière aseptique, sortir la sonde de l'emballage stérile. Voir MISES EN GARDE ! Section A.

2 Tendre l'extrémité du connecteur à l'infirmier(e) de bloc et visser le connecteur dans le laser. S'assurer que le connecteur est bien serré.

3 Tendre l'extrémité du connecteur source de lumière à l'infirmier(e) de bloc et brancher le connecteur dans la source de lumière.

4 Fixer le clamp sur une zone pratique du champ stérile. NE PAS PINCER LE CABLE DE LA FIBRE.

5 Vérifier que le laser affiche le type de sonde voulu avant de passer en mode PRET ou de permettre un tir laser. Voir MISES EN GARDE ! Section D.

6 Tester la sonde en dirigeant le faisceau de visée rouge sur une surface non réfléchissante, voir MISES EN GARDE ! Section E. Voir MISES EN GARDE ! Sections P et O.

### Mode d'emploi de la sonde laser, de la sonde laser éclairante et de la sonde laser aspirante uniquement :

Pour une utilisation d'une source laser avec un laser Alcon® 532 nm

#### Pour les sondes lasers éclairantes uniquement :

Pour une utilisation de la source de lumière avec le **Constellation** Vision System, la console **Accurus**\* ou le système illuminateur Haute Luminosité (HHL) **Accurus**\*. Les sondes avec RFID **ENGauge**\* peuvent être utilisées avec la console **Accurus**\* ou le système illuminateur Haute Luminosité (HHL) **Accurus**\* en utilisant l'adaptateur RFID modèle numéro 8065751140.

1 De manière aseptique, sortir la sonde de l'emballage stérile. Voir MISES EN GARDE ! Section A.

2 Tendre l'extrémité du connecteur à l'infirmier(e) de bloc et visser le connecteur dans le laser. S'assurer que le connecteur est bien serré.

3 Pour les sondes lasers éclairantes uniquement : Tendre l'extrémité du connecteur source de lumière à l'infirmier(e) de bloc et brancher le connecteur dans la source de lumière.

4 Fixer le clamp sur une zone pratique du champ stérile. NE PAS PINCER LE CABLE DE LA FIBRE.

5 Vérifier que le laser affiche le type de sonde voulu avant de passer en mode PRET ou de permettre un tir laser. Voir MISES EN GARDE ! Sections D et L.

6 Tester la sonde en dirigeant le faisceau de visée rouge sur une surface non réfléchissante, voir MISES EN GARDE ! Section E.

7 Pour les sondes lasers éclairantes uniquement : Allumer la lumière et vérifier le rendement de la lumière à travers la fibre. Voir MISES EN GARDE ! Sections N et O.

8 Pour les sondes lasers aspirantes uniquement :

#### ASPIRATION PASSIVE

- Placer le bouchon sur l'extrémité proximale de la tubulure.
- Retirer le bouchon en métal de l'ampoule de reflux.

#### ASPIRATION ACTIVE

- Connecter l'extrémité proximale de la tubulure à la source d'aspiration.
- Vérifier que le bouchon en métal est inséré dans l'ampoule de reflux.
- Retirer toutes les bulles d'air de la pièce à main et de la tubulure avant utilisation.

**ATTENTION :** Ne pas ouvrir plus d'une voie de liquide en même temps, une mauvaise aspiration pourrait en résulter.

### ATTENTION

A Aux Etats-Unis, la loi restreint la vente de ce dispositif soit directement par les médecins, soit sur leur prescription (sur prescription, seulement).

### MISES EN GARDE !

A Si la sonde est défectueuse à réception, Alcon doit être averti immédiatement. Ne pas utiliser la sonde si l'emballage de stérilité est endommagé ou si l'emballage est ouvert. Dans ce cas, veuillez contacter :

Pour la France :  
Téléphone : 01.47.10.47.58 (Matérielovigilance)  
0.800.07.14.27 (Service Clients)  
Mail : vigilances.france@alcon.com

Pour la Belgique et le Luxembourg :  
Téléphone : 02.754.32.10  
Courrier : Alcon NV  
Mediaanlaan 36  
B-1800 VILVORDE

Pour la Suisse :  
Courrier : Alcon Switzerland S.A.  
Sürströffli 14  
CH-6343 ROTKREUZ

Chaque emballage est identifié par un numéro de lot qui permet la traçabilité et doit être rappelé lors de toute discussion avec le Service Clients au sujet de la sonde.

B L'orifice du laser est à l'extrémité de la Fibre/Applicateur.

C Ce dispositif doit être utilisé avec un microscope équipé d'un interrupteur de sécurité comportant un filtre laser approprié à la longueur d'onde utilisée.

D Tout le personnel dans la salle de soin doit porter des lunettes de protection (OD 4 ou supérieure à 532 nm) lorsque le système est en Veille ou en mode Prêt.

E Puisque le faisceau de visée et le faisceau de traitement passent par le même système de délivrance, ceci est un bon moyen de vérifier l'intégrité du système de délivrance. Si la lumière du faisceau de visée n'est pas présente à la partie distale du système de délivrance, ou si son intensité est réduite ou si elle semble diffuse, ceci peut être l'indication d'une détérioration ou d'un mauvais fonctionnement du système de délivrance. En cas de doute, contacter le Service Clients. Ne pas regarder le faisceau de visée directement, vérifier la présence du faisceau de visée de façon indirecte.

F Ne pas activer le tir du faisceau laser de traitement lorsque l'embout de la sonde est à l'extérieur de l'œil du patient afin de prévenir les risques en matière de santé et de sécurité associés aux radiations laser, et d'éviter les dommages possibles de l'embout de la sonde.

G L'utilisation d'anesthésiques inflammables ou de gaz oxydants comme l'oxyde nitreux (N<sub>2</sub>O) et l'oxygène devra être évitée. Certains matériaux - par exemple le coton lorsqu'il est saturé d'oxygène - peuvent prendre feu avec les températures élevées produites lors de l'usage normal de l'appareil laser. Avant d'utiliser l'appareil laser, il faudra laisser s'évaporer les scories de la solution adhésive et inflammable utilisée pour le nettoyage et la désinfection. Il existe également un danger d'inflammation des gaz endogènes.

H Ces dispositifs ne sont destinés qu'à une seule intervention. La réutilisation, un usage incorrect ou un mauvais assemblage peuvent être dangereux pour le patient. Alcon décline toute responsabilité en cas de complications qui peuvent résulter de la réutilisation ou de l'usage incorrect de ce dispositif.

I Les risques potentiels d'une réutilisation ou d'un retraitement incluent : une phototoxicité liée à l'exposition à un laser ou à une illumination irrégulière en raison d'une fibre ou d'un connecteur endommagé, une puissance de laser ou d'illumination réduite, des fuites ou une obstruction des voies des fluides résultant d'unes performances fluidiques réduites et l'introduction de corps étrangers dans l'œil.

J Il existe des dangers potentiels quand la fibre optique est insérée, courbée fortement ou fixée de façon incorrecte. Ne pas suivre les recommandations du fabricant peut entraîner une détérioration de la fibre ou du système de délivrance et/ou être dangereux pour le patient ou l'utilisateur.

K L'équipement utilisé en association avec la sonde laser Alcon® constitue un système complet. L'utilisation de consommables autres que ceux d'Alcon peut affecter la performance du système et être potentiellement dangereuse ; si s'il est acquis que ceci a contribué au dysfonctionnement de l'appareil sous contrat, ce dernier pourrait être annulé et/ou le taux horaire en vigueur pourrait être facturé.

L Tous les liquides aspirés pendant l'opération doivent être traités comme potentiellement contaminants. Prendre les précautions appropriées lors de la manipulation des appareils et des lignes en contact avec les fluides aspirés.

M Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que les sondes non-RFID sont correctement identifiées.

N Pour la sonde laser à embout flexible uniquement : Lors de l'insertion ou du retrait d'une sonde laser à embout flexible, l'embout peut changer de profil ou d'orientation. Eviter tout contact entre l'embout flexible et les tissus oculaires environnants car cela pourrait être dangereux pour le patient.

O Pour les sondes lasers éclairantes uniquement : Minimiser l'intensité de la lumière et la durée d'exposition de la rétine afin de réduire les risques de lésions de la zone rétinienne.

P Pour les sondes lasers éclairantes uniquement : Eviter d'utiliser la sonde d'éclairage dans l'air monté sur des consoles capables d'atteindre des niveaux et réglages d'éclairage supérieurs à 10 lumens. Ceci peut provoquer une déformation de la sonde et/ou des températures de surface élevées qui peuvent potentiellement être dangereuses pour le patient.

Q Pour la SONDE LASER ARTICULÉE ÉCLAIRANTE **Vektor**\* uniquement : Avant d'insérer ou de retirer une sonde laser articulée, s'assurer que l'embout courbe est complètement rétracté avec le bouton poussoir, afin d'éviter tout dommage de la capsule postérieure du cristallin, et/ou des autres tissus oculaires environnants, et/ou de l'embout de la sonde.

R Pour la SONDE LASER ARTICULÉE ÉCLAIRANTE **Vektor**\* uniquement : Lors de l'ajustement dans l'œil de l'embout courbe d'une sonde laser articulée, maintenir l'embout éloigné de tout tissu oculaire environnant, pour éviter que les tissus ne soient pris au piège, ce qui est potentiellement dangereux pour le patient.

Définitions des symboles pouvant apparaître sur l'étiquetage du produit :

SE REFERER AU MODE D'EMPLOI	OUVERTURE	FABRICANT	DIADEMRE
	UTILISER AVANT		STRAIGHT
	NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ		DATE DE FABRICATION
	LOT	LOT N°	
	REF	CODE ARTICLE	EC REP
	STERILE	NE CONTIENT NI LATEX, NI CAOUTCHOUC NATUREL SEC	STERILE
	STERILE PAR RAYONNEMENT	ATTENTION : AUX ETATS-UNIS, L'ALO RESTREINT LA VENTE DE CE DISPOSITIF, SOIT DIRECTEMENT PAR LES MEDECINS, SOIT SUR LEUR PRESCRIPTION	STERILE PAR L'OXIDE DE ETHYLENE
	STERILE PAR L'OXIDE DE ETHYLENE	ATTENTION : AUX ETATS-UNIS, L'ALO RESTREINT LA VENTE DE CE DISPOSITIF, SOIT DIRECTEMENT PAR LES MEDECINS, SOIT SUR LEUR PRESCRIPTION	STERILE PAR L'OXIDE DE ETHYLENE
	CONNECTEUR INFINITECH®	CONNECTEUR ACM®	CONNECTEUR ACM®
			CONNECTEUR ACM®



Brevets en cours.  
\*une marque déposée de Novartis


\*\* Les noms de marque sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

© 2007, 2015 Novartis

ALCON LABORATORIES, INC.

6201 SOUTH FREEWAY  
FORT WORTH, TX 76134-2098 USA  
a Novartis company  
FABRIQUE AUX ETATS-UNIS

460-1326-001 REV. J




Languages not translated:

Chinese

Japanese

Latvian

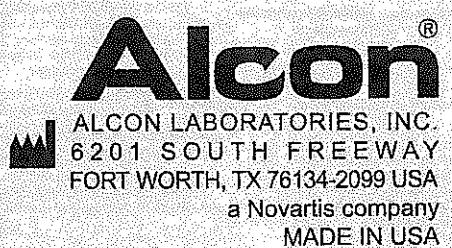

460-1326-050 Rev. G